ja

EVOFLEX
骨盤支持ベルトの取付・取扱説明書

ART NOS. EB205, EB225, EB235 & EB275

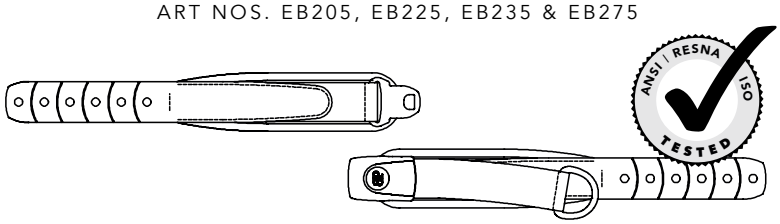

この説明書にはBodypointのEvoflex骨盤支持ベルトの安全な使用とメンテナンスに必要な重要情報が記載されています。使用者またはその介護人にこの説明書を渡し、内容を説明して、インストラクションが確実に理解されるようにしてください。

⚠警告！製品は有資格のリハビリ技師が取付け、固定してください。

車椅子や座位保持装置への取付けには、オプションのBODYPOINTベルト取付けハードウェアを使用することができます。

⚠警告！本製品は車椅子または作業椅子に座っている人の位置決めにのみ使用してください。輸送用安全装置、個人用拘束装置としての使用、または故障が傷害を招く可能性のあるその他の適応での使用は意図していません。本製品の誤用は認可されず、危険です。

⚠警告！この骨盤支持ベルトは、下部骨盤部または大腿部に常にぴったり固定しておくと、摩耗します。ベルトがゆるいと、使用者が滑り抜けて頸部を圧迫する危険があります。シーティングの専門家に適切な調節と使用について実地説明をしてもらってください。(注：4点式ベルトは、二次ストラップが固定されて位置の変更が防止されれば、上部骨盤部に安全に着用することができます。)

⚠警告！本製品が誤って外れると、使用者が滑り抜けたり、車椅子や作業椅子から落ちたりする可能性があります。使用者の動作または認識能力によって誤って外れる可能性がある場合、使用中は常に介護人が付き添う必要があります。介護人は必ず本製品の外し方を知っておく必要があります。これができないと、緊急時に取り外しが遅れる恐れがあります。

⚠警告！新しい座位保持装置と同様に、この製品により人の座り方が変わる可能性があります。使用者は、この製品が使用者に接触する部位だけでなく、仙骨、脚、臀部など圧力を受ける主な部分について、通常の圧力開放と皮膚の完全性チェックを引き続き実行しなければなりません。皮膚の赤みが増したり、炎症が起きる場合は、使用を止めて、医師かシーティングの専門家に相談してください。そのままにしておくと、褥瘡など重傷を負う恐れがあります。

メンテナンス：縫い目、ウェビング、パッドに摩耗の兆候がないか、定期的に点検してください。大きな摩耗があった場合は、サプライヤーに連絡してBODYPOINTの認定修理または交換を受けてください。いかなる場合も、資格のない人がこの製品を変更したり、修理したりしないでください。健康と安全がそれにかかっています！

洗浄：洗濯機洗い、温水、60°C (140°F)。漂白しないこと。乾燥機乾燥、低温、またはそのまま干して乾燥。アイロンをかけないこと。(洗濯中は製品を布袋に入れ、製品やマシンに傷が付かないようにしてください。)

保証：この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBODYPOINTに連絡してください。

BODYPOINT製品の詳細情報、および米国外の販売代理店の一覧は、WWW.BODY-POINT.COMをご覧ください。

Bodypoint®

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

© 2019 Bodypoint, Inc. All Rights Reserved.

BPI092-ja 2020.13

ja

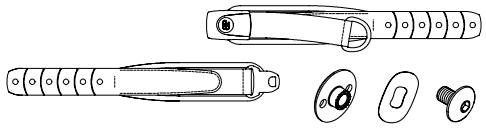

パッケージの内容
EVOFLEXベルト
M6 X 8ねじ
M6低背型フランジナット
ばね座金

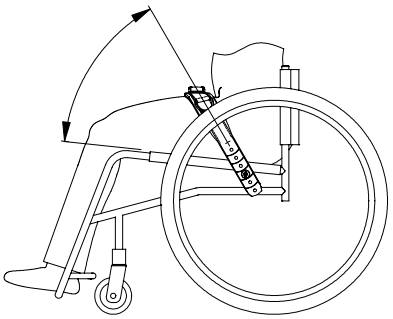

ベルト位置
推奨されるベルト角度は、使用者の配置ニーズに従い、シートから30°～90°です。調節ストラップを完全に締めて調節してベルトの最適の位置を決め、所望の定着点を定めてから図示の取付方法を選択します。

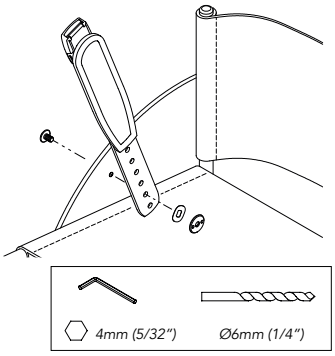

側方ガードの取付け
ドリルで6MM (1/4インチ) の穴を開けるか、または既存の穴/スロットを使用し、同梱の留め具を使用してベルトを装着します。

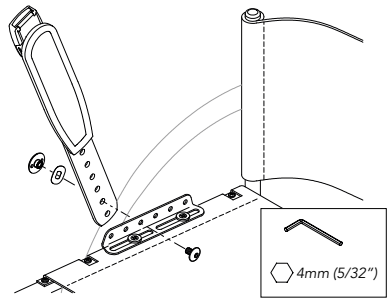

シートチューブの取付け
(物品番号HW312-キット必要)

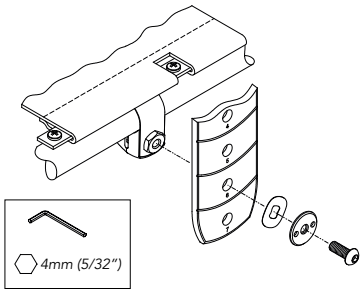

バンドクランプまたはフレームクランプ取り付け
(製品番号NO. HW320 OR HW310)
シートチューブにクランプを取り付けます。クランプ付属のM6ネジを使用してベルトを取り付けます。

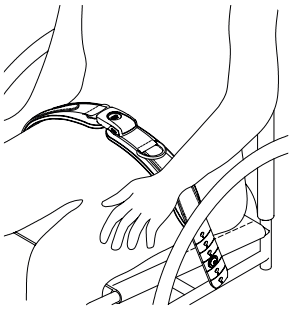

調節
ベルトの回転を制限するには、同梱されているばね座金を使用してください。横方向に移動しやすくするには、ワッシャーを省いてください。
正しく調節してベルトを締めると、ぴったり合って使用者の骨盤が安定します。緩みがなくなり、バックルの下のパッドが当たるまで、Dリング プルを締めます。長さを調節してぴったり合わせたり、クリーニングのためにベルトを外したりすることが必要な場合、ベルトのエンド ストラップで行なうことができます。

安全点検
車椅子に適正に配置したら、使用者に前方や左右交互に傾いてもらい、固定を確認します。確認事項：
1. バックルや調節ストラップの正常な動作。
2. 快適度 - 刺激のある領域がないか探します。
3. 位置 - 高すぎたり低すぎたりすれば、定着点を調節します。
4. 他の装置の妨害 – 定着点を必要に応じて定め直します。
5. 傾き、折畳み、巻上げ等、あらゆる範囲の動きを通じて椅子を動かします。何か妨害物がないか確認します。

ja

EVOFLEX
ベルトエクステンダー

ART NO. EBE100

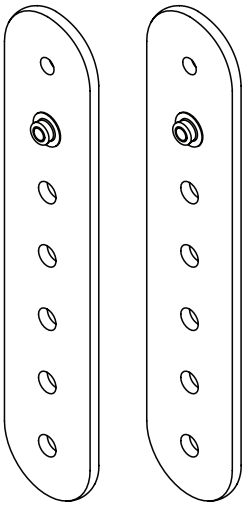



パッケージの内容

- Evoflex ベルトエクステンダー 2 個セット
- M6 x 8 mm スクリュー
- M6 ロープロファイル・フランジナット

本説明書にはBodypoint Evoflexのすべてのベルトエクステンダーの安全な使用方法とメンテナンスに必要な情報が記載されています。使用者または介護者にこの説明書を渡し、内容を説明して、使い方を理解していることを確認してください。

車椅子や座位保持装置への取付けには、オプションのBodypointベルト取付けハードウェアを使用することができます。

本製品は取付け位置決めベルトやハーネスの取付けを意図しています。輸送用安全装置としての使用は意図していません。

保証

この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBodypointに連絡してください。

Bodypoint製品の詳細情報、および米国外の販売代理店の一覧は、www.bodypoint.comをご覧ください。

Bodypoint®

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 D-30175 Hannover Germany

CE

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

© 2020 Bodypoint, Inc. All Rights Resereved.

取り付けオプション（別途購入）

ベルトエクステンダーは、バンドクランプ（製品番号HW320）、フレームクランプ（製品番号HW310）、シートマウントブラケット（製品番号HW200）、またはT字スロットファスナーを使用して車椅子に取り付けること可能です（製品番号HKA6 HKA10）。

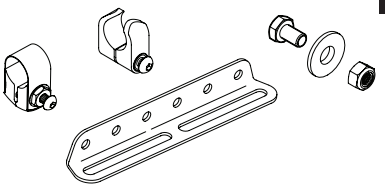

取付け

Evoflexにベルトエクステンダーを取り付けます。スプリングワッシャーは使用しません。



ベルトの回転不可。（ピン内向き）

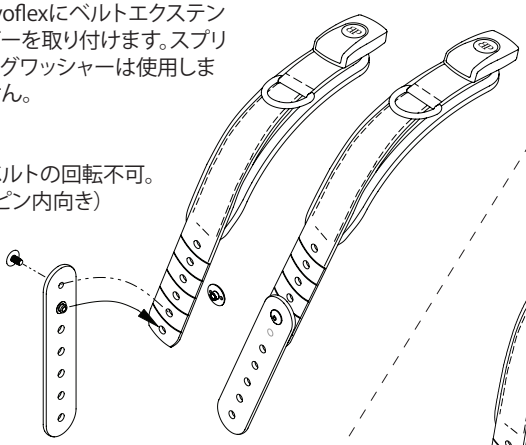

ベルトの回転可能。（ピン外向き）

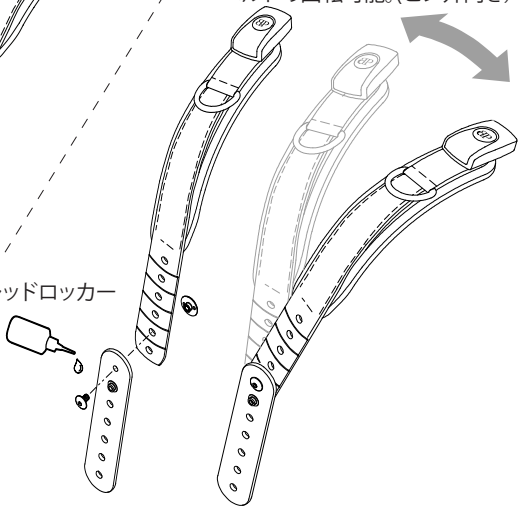

スレッドロッカー

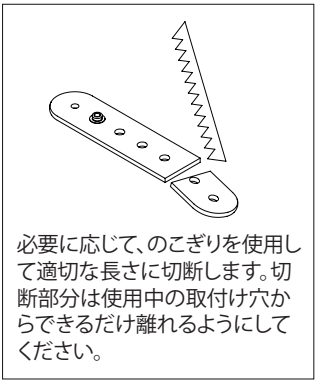

必要に応じて、のこぎりを使用して適切な長さに切断します。切断部分は使用中の取付け穴からできるだけ離れるようにしてください。

取付け

Evoflex付きベルトエクステンダーを車椅子に取り付けます。詳細については、Evoflex製品の説明書を参照してください。（スプリングワッシャーはオプションです）



バンドクランプまたはフレームクランプ



シート取付けブラケットキット



T字スロットファスナー